

Số: 01 /TM-BVNS

Nga Sơn, ngày 1 tháng 11 năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v mời chào giá bóng phát tia X cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính Brivo CT 325 tại  
Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

Kính gửi: Các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực cung ứng các mặt hàng liên quan

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn đang có nhu cầu mua sắm thay thế bóng phát tia X cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính Brivo CT 325 Hãng sản xuất: GE Healthcare tại Bệnh viện.

Để có cơ sở lập kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ điều kiện và năng lực, cung cấp các hồ sơ liên quan và gửi về phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn trước 8h00 ngày 11 tháng 11 năm 2023. Các tài liệu bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản chụp chứng minh doanh nghiệp có tên trên cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ kế hoạch và Đầu tư
- Bảng báo giá: Nội dung chào giá Cung cấp bóng phát tia X cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính Brivo CT 325

Hồ sơ báo giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung

Hồ sơ xin gửi về: Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Tiểu khu 3, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.


Rất mong sự hồi đáp của quý đơn vị

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC

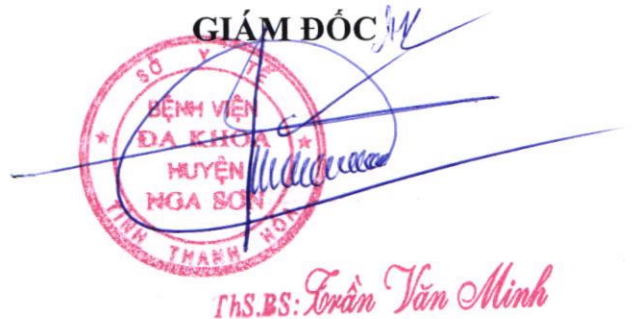

T.H.S.B.S: *Lưu Văn Minh*

**PHỤ LỤC**

**Danh mục hàng hóa, thiết bị, dịch vụ liên quan đề nghị chào giá**

*(Đính kèm Thư mời chào giá Số: 01/TM-BVNS ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn)*

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	<b>Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính Brivo CT 325</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước tiêu điểm bóng tia: 0,7 (rộng) x 0,6 (dài) (tiêu chuẩn IEC 336/93).</li><li>- Góc bia: 7°</li><li>- Tốc độ quay nhỏ nhất: 8000 rpm.</li><li>- Công suất tối đa: 24 kW</li><li>- Công suất trữ nhiệt của Anode: 2000 kHU (tương đương 1500 kJ).</li><li>- Công suất trữ nhiệt của bóng tia X: 3400 kHU (tương đương 2518 kJ).</li><li>- Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: 500 kHU/phút.</li><li>- Tốc độ tản nhiệt liên tục của bóng: 300 kHU/phút.</li></ul>	01	Cái	

TÊN CÔNG TY BẢO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../BG-.....

....., Ngày ..... Tháng ..... Năm .....

## BẢO GIÁ

### CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

Chúng tôi là....., có địa chỉ tại....., mã số thuế..... Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mã kê khai (nếu có)	Chủng loại, ký mã hiệu (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											

- Hiệu lực báo giá:.....
  - Điều kiện thanh toán:.....
  - Mới 100%, sản xuất từ năm:.....
  - Chi phí vận chuyển, giao hàng:.....
  - Thời gian giao hàng:.....ngày kể từ ngày nhận được thông tin gọi hàng.
  - Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Triều Khu 3, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
    - Số điện thoại liên hệ:.....
- Tài liệu kèm theo Báo giá gồm có:
1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) (nếu có).
  2. Tài liệu mô tả sản phẩm như: Catalog, thuyết minh tính năng kỹ thuật...
  3. Bản in kê khai giá tại địa chỉ: <http://kekhaijiatbt.yt.moh.gov.vn>

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**